

Control Respiratorio Descrito por Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Interpretadas con el Simulador Genérico SERVOGLU

Osmany Orozco^{1*}, María Velasco Pineda¹, Carolina Arámbulo², Ignacio Ferrer² y Franco Simini²

¹Facultad de Tecnologías de Información, Universidad De La Salle, León, Guanajuato, México

²Núcleo de Ingeniería Biomédica de las Facultades de Medicina e Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay

* oosmany@gmail.com

Resumen— Se utiliza un modelo del control del sistema respiratorio basado en ecuaciones diferenciales ordinarias para la generación del código en MathML, el cual por medio del simulador de ecuaciones diferenciales ordinarias SERVOGLU, muestra el intercambio de gases en tres compartimientos del cuerpo humano: cerebro, tejidos (cuerpo) y pulmones.

Palabras clave—SERVOGLU, Modelo, Respiratorio

I. INTRODUCCIÓN

Mediante la creación y desarrollo de software médico se ha facilitado el trabajo de los médicos al momento de realizar diagnósticos y pronosticar la evolución de un paciente. En este estudio se busca aumentar los alcances del simulador SERVOGLU, que es un software de escritorio cuyo objetivo es simular mediante gráficas un modelo fisiológico, descrito por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) [1]. Se le aplica a SERVOGLU el Modelo Matemático del Sistema de Control Respiratorio [2] el cual muestra cómo se realiza el proceso de aumento y disminución de gases a través de tres compartimientos: como el cerebro, los alveolos y el tejido del cuerpo.

II. METODOLOGÍA

Se estudió el funcionamiento de SERVOGLU [1], en el cual se puede aplicar un modelo matemático compuesto por ecuaciones diferenciales ordinarias de algún sistema o proceso fisiológico para su simulación. Primeramente, se hizo una revisión de cómo se realiza la transformación de un modelo matemático al código MathML, ya que esto es lo que utiliza SERVOGLU para realizar la simulación. Posteriormente, se hizo una revisión de la literatura para encontrar un modelo validado que pudiera ser de utilidad para su aplicación y que contara con las características necesarias para poder ser trasladado a código. Se tomaron en cuenta diferentes publicaciones tales como el Modelado de Circulación Sanguínea Cerebral [3], y la Estimación de Parámetros del HIV [4]. Se decidió tomar un Modelo del Sistema de Control Respiratorio que muestra las

concentraciones de O₂ y CO₂ en tejidos del cuerpo, alveolos y cerebro. Para la generación de código se recurrió al conversor *online* de uso gratuito MathML Central de Wolfram.

III. MODELO DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Las ecuaciones utilizadas para simular el Sistema fueron las siguientes[2], donde cada variable está definida en la Tabla 1:

Control de circulación cerebral:

$$(1) \dot{Q}B = W[h(CA\varphi_{CO_2})^5 + i(CA\varphi_{CO_2})^4 + j(CA\varphi_{CO_2})^3 + p(CA\varphi_{CO_2})^2 + qCA\varphi_{CO_2} + r + f\left(g - \frac{1}{k_5}CA\varphi_{O_2}\right)^3] + \dot{Q}BN$$

Control de ventilación que representa la función de transferencia de estado estable:

$$(2) \dot{V}A = a(CB_{CO_2})^{1/k_2} - b + d(m - k_5PBCA\beta_{O_2})^n \geq 0$$

Concentración de CO₂ del tejido cerebral:

$$(3) \frac{dCB_{CO_2}}{dt} = (1/VB)\{MB_{CO_2} + \dot{Q}B[k_1(PBCA\varphi_{CO_2})^{k_2} - CB_{CO_2}]\}$$

Concentración de CO₂ del tejido corporal:

$$(4) \frac{dCT_{CO_2}}{dt} = (1/VT)\{MT_{CO_2} + (\dot{Q} - \dot{Q}B)[k_1(PBCA\alpha_{CO_2})^{k_2} - CT_{CO_2}]\}$$

Concentración de CO₂ en los alveolos:

$$(5) \frac{dCA_{CO_2}}{dt} = (1/VA)\{\dot{Q}B(CB\theta_{CO_2} - CT\delta_{CO_2}) + \dot{Q}[CT\delta_{CO_2} - k_1(PBCA_{CO_2})^{k_2}] + \dot{V}A(CI_{CO_2} - CA_{CO_2})\}$$

Concentración de O₂ del tejido cerebral:

$$(6) \quad dCB_{O_2}/dt = (1/VB)\{-MB_{O_2} + k_3\dot{Q}B[(1 - \exp(-k_4k_5PBCA\phi_{O_2}))^2 - (1 - \exp(-k_4PBCB_{O_2}/S))^2]\}$$

Concentración de O₂ del tejido corporal:

$$(7) \quad dCT_{O_2}/dt = (1/VT)\{-MT_{O_2} + k_3(\dot{Q} - \dot{Q}B)[(1 - \exp(-k_4k_5PBCA\alpha_{O_2}))^2 - (1 - \exp(-k_4PBCB_{O_2}/S))^2]\}$$

Concentración de O₂ en los alveolos:

$$(8) \quad dCA_{O_2}/dt = (1/VA)\{k_3\dot{Q}B[(1 - \exp(-k_4PBCB\theta_{O_2}/S))^2 - (1 - \exp(-k_4PBCB\delta_{O_2}/S))^2] + k_3\dot{Q}[(1 - \exp(-k_4PBCB\delta_{O_2}/S))^2 - (1 - \exp(-k_4k_5PBCA_{O_2}))^2] + \dot{V}A(CI_{O_2} - CA_{O_2})\}$$

En la Tabla I se muestra la nomenclatura que se le da a cada variable y constante del sistema:

TABLA I
NOMENCLATURA DE VARIABLES Y CONSTANTES

Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre	
MBCO ₂	Producción CO ₂ Cerebral	W	Constante que equivale al aumento de cada 100 g del peso del cerebro normal (1400 g), dividido entre 1000 para convertir cc a litros, multiplicado por el flujo sanguíneo cerebral (50 cc/100 g/ min)	
MTCO ₂	Producción CO ₂ Corporal	CICO ₂	Concentración de CO ₂ inspirado	
MBO ₂	Producción O ₂ Cerebral	CIO ₂	Concentración de O ₂ inspirado	
MTO ₂	Producción O ₂ Corporal	S	Constante	
PB	Presión atmosférica	a	Constantes de la ecuación de control ventilatorio	
k ₁	Constantes obtenidas de la curva de disociación del CO ₂ y O ₂	b		
k ₂		d		
k ₃		n		
k ₄		m	Presión normal arterial	
k ₅	Constante obtenida de dividir la Presión normal arterial por la Presión normal alveolar.	VT	Volumen de fluidos corporales	
\dot{Q}	Gasto cardíaco	VA	Volumen alveolar promedio	
h	Constantes obtenidas a partir de la curva de ventilación alveolar	VB	Volumen de fluido cerebral	
i		$\dot{Q}B$	Flujo sanguíneo cerebral	
j		$\dot{V}A$	Ventilación alveolar	
p		CBCO ₂	Concentración de CO ₂ cerebral	
q		CTCO ₂	Concentración de CO ₂ corporal	
r		CACO ₂	Concentración de CO ₂ alveolar	
f		CBO ₂	Concentración de O ₂ cerebral	
s		CTO ₂	Concentración de O ₂ corporal	
g		Presión normal arterial	CAO ₂	Concentración de O ₂ alveolar

En la Tabla II se muestran los valores iniciales de las constantes y de las variables del modelo, ya definidas en la Tabla I.

TABLA II
CONSTANTES FISIOLÓGICAS Y VALORES INICIALES DEL
MODELO RESPIRATORIO

Símbolo	Valor	Símbolo	Valor
MBCO ₂	0.042 L/min	W	0.014 g-L/cc
MTCO ₂	0.221 L/min	* CICO ₂	0
MBO ₂	0.042 L/min	* CIO ₂	0.1967
MTO ₂	0.221 L/min	S	0.024 atm ⁻¹
PB	760 mm Hg	a	99
k ₁	0.107	b	19.6
k ₂	0.415	d	8x10 ⁻⁴
k ₃	0.2	n	3.0
k ₄	0.05	m	98 mm Hg
k ₅	0.92	VT	39.1 L
Q̇	6.0 L/min	VA	3 L
h	(760) ⁵ (3.23431x10 ⁻⁶)	VB	0.9 L
i	-(760) ⁴ (4.46082 x10 ⁻⁴)	*Q̇B	0.7 L/min
j	(760) ³ (2.25409 x10 ⁻²)	*V̇A	4.7 L/min
p	-(760) ² (4.79044 x10 ⁻¹)	CBCO ₂	55.9 v %
q	(760)(4.36567)	CTCO ₂	54.0 v %
r	43	CACO ₂	5.6 v %
f	0.005	CBO ₂	0.110 v %
s	2.3	CTO ₂	0.134 v %
g	98 mm Hg	CAO ₂	14.1 v %

Estas constantes se refieren a la situación normal de un paciente
*Valores de las variables asignados por el operador (Se indican aquí los valores iniciales).

IV. SERVOGLU

Se implementa SERVOGLU como simulador de conductas clínicas para el manejo y seguimiento de sistemas fisiológicos. Esto permite manipular y controlar virtualmente el sistema simulado, pudiendo modificar las variables del fenómeno [5]. La entrada a SERVOGLU es un modelo fisiológico matemático que contiene sus características generales: ecuaciones, constantes, parámetros y otras opciones de configuración [1]. Los modelos a simular están basados en ecuaciones diferenciales de primer orden (EDOs) del tipo $dy/dt = f$. Se definen las ecuaciones que se simularán y además se especifican las variables que podrán ser modificadas una vez que haya iniciado la simulación. El

resultado posterior es la evolución de las variables de las EDOs que se fueron alternando a lo largo de la simulación.

V. CÓDIGO

Con las ecuaciones presentadas se realiza su representación en MathML para que pueda ser usado como un archivo XML de entrada en SERVOGLU. Por medio del uso del conversor de expresiones a código de Wolfram Research se obtuvo un código capaz de ser utilizado en SERVOGLU. Para ello se deben declarar los parámetros, funciones, y expresiones que serán usados.

```

</parameters>
<constants>
  <constant name="MBO2" description="" unit="L/min" calculated="False">
    <m:math>
      <apply>
        <eq />
        <ci>MBO2</ci>
        <cn type="real">0.042</cn>
      </apply>
    </m:math>
  </constant>
  <constant name="MBCO2" description="" unit="L/min" calculated="False">
    <m:math>
      <apply>
        <eq />
        <ci>MBCO2</ci>
        <cn type="real">0.042</cn>
      </apply>
    </m:math>
  </constant>
  <constant name="k1" description="" unit="" calculated="False">
    <m:math>
      <apply>
        <eq />
        <ci>k1</ci>
        <cn type="real">0.107</cn>
      </apply>
    </m:math>
  </constant>
  <constant name="k2" description="" unit="" calculated="False">
    <m:math>
      <apply>
        <eq />
        <ci>k2</ci>
        <cn type="real">0.415</cn>
      </apply>
    </m:math>
  </constant>

```

Fig. 1. Ejemplo de declaración de constantes en lenguaje MathML

VI. RESULTADOS

En la Fig. 2 se muestra la ventilación exitosa de 5% de O₂ hasta bajar al 1% todo con 4,7 L/min de ventilación minuto. De una concentración de O₂ alveolar insuficiente (aprox. 20 unidades de concentración), la ventilación con O₂ llega en la hora 52 a superar 150 unidades de concentración. Luego de 18 horas de ventilación intensa (al 5% de O₂) la simulación baja a 1% de concentración.

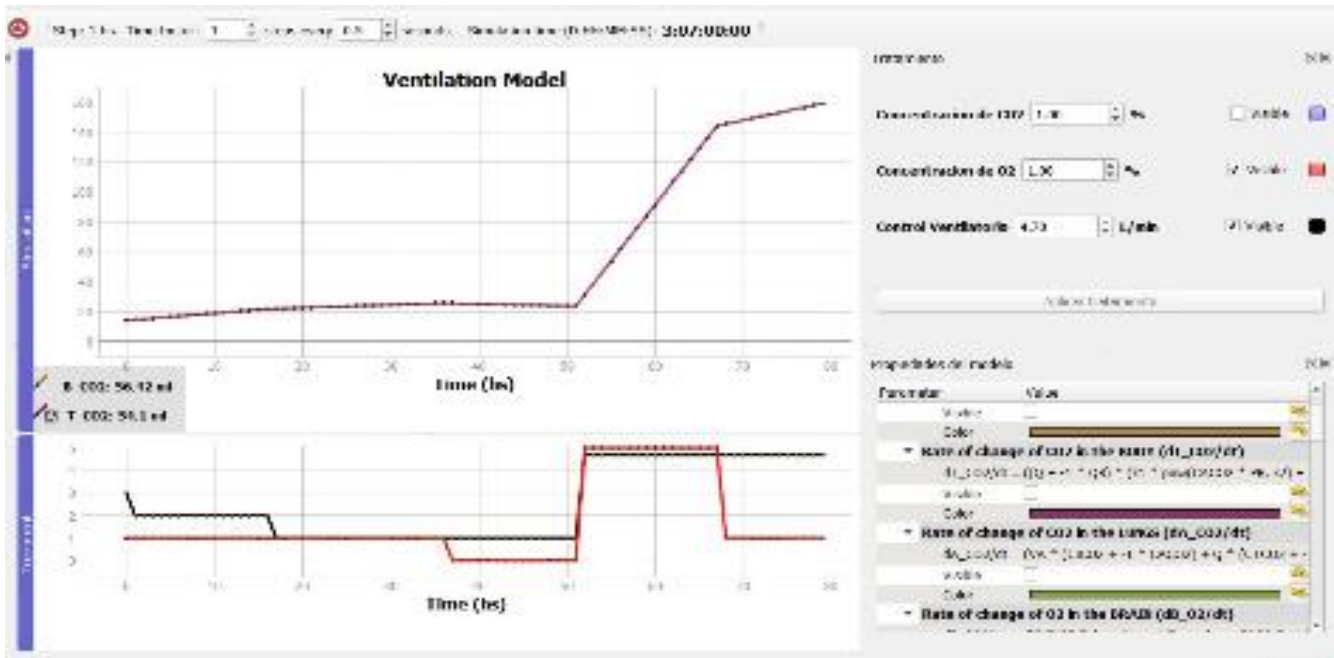


Fig. 2 Simulación de un paciente en condiciones de baja oxigenación y ventilación

VII. DISCUSION Y CONCLUSION

Mediante la simulación de un sistema complejo como es el respiratorio, se aprecian sus características dinámicas mediante la fijación de condiciones iniciales y la manipulación de tratamientos o influencias externas a lo largo de la simulación. El modelo de Milhorn et al. Fue bien convertido a lenguaje MathML con lo cual pudo ser incluido en SERVOGLU que lo ejecutó en una serie de sesiones de exploración sin límites más que la imaginación y la curiosidad del operador. Una situación de hipoxia severa fue revertida con una combinación de mezcla de gases rica en O_2 y con una ventilación minuto que permitió alcanzar niveles de oxigenación normales, como se muestra en la figura 2.

La utilidad de la simulación en la actividad clínica, como prueba antes de aplicar terapias precisas, no puede ser más enfatizada en este momento en que los medios telemáticos están a disposición de los diferentes estamentos del quehacer médico. Además se percibe, como consecuencia de las simulaciones desarrolladas para este trabajo que la enseñanza de sistemas complejos como es el sistema respiratorio puede volverse más amena y provechosa con el uso de SERVOGLU, oportunamente programado por los docentes. Los estudiantes y profesionales en fase de especialización, al tener la posibilidad de simular repetidamente las respuestas a sus intervenciones en ausencia de pacientes reales, tendrán la oportunidad de un mejor aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] G. Ashby, I. Ferrer, and F. Simini, "SERVOGLU: simulador gráfico de sistemas fisiológicos basados en ecuaciones diferenciales para enseñanza y ensayo de conductas clínicas," in *XXI Congreso Argentino de Bioingeniería X Jornada de Ingeniería Clínica*, 2017.
- [2] H. T. Milhorn, R. Benton, R. Ross, and A. C. Guyton, "A Mathematical Model of the Human Respiratory Control System," *Biophysical Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 27–46, Jan-1965.
- [3] R. Lampe, N. Botkin, V. Turova, T. Blumenstein, and A. Alves-Pinto, "Mathematical modelling of cerebral blood circulation and cerebral autoregulation: Towards preventing intracranial hemorrhages in preterm newborns," *Comput. Math. Methods Med.*, vol. 2014, 2014.
- [4] Y. Yu and H. Liang, "Parameter estimation for HIV ODE models incorporating longitudinal structure," *Stat. Interface*, vol. 6, no. 1, pp. 9–18, 2013.
- [5] J. G. López and L. V. Spirko, "Simulación, herramienta para la educación médica," *Salud Uninorte*, vol. 23, no. 1, pp. 79–95, 2007.